Commandez ici ! PRAXISDIENST
Matériel médical depuis 1953

HAGER WERKEN

F Mode d´emploi

CROWN-CLICK® DE LUXE – Embout pour boucle

Avertissement : le produit doit être, avant la première utilisation et après chaque utilisation suivante, nettoyé, désinfecté et stérilisé selon les instructions pour la préparation ci-jointes.

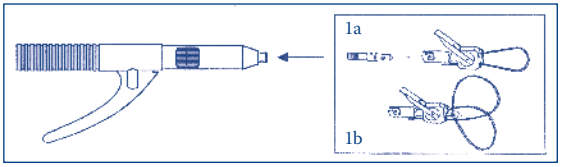







Présentation :

Set boucle avec adaptateur	REF 452 209
Fil de boucle de rechange, 2 pcs	REF 452 210

Comme le montrent les illustrations **1a** et **1b**, la boucle est rattachée à l'instrument grâce à un adaptateur qui vient se visser à son extrémité.
Emploi de la boucle : Après avoir placé l´extrémité fine du câble sous le pontic près de l´élément de bridge, on enfile ce câble dans le porte-câble et le fixe avec la fermeture excentrique **(2+4)**.
En cas d´éléments de bridges plus importants, il est recommandé de travailler avec 1 câble double. On place une boucle à un pontic du bridge et l´autre á l´autre pontic, ce qui répartit la force de l´onde de choc de manière régulière **(3)**.

Utilisation de la clé :

a) Visser à fond la vis de la boucle dans le porte-câble à l´aide de la clé

b) Mettre l´adaptateur en place en le vissant dans l´arrache-couronnes-et-bridges (enfoncer la petite barrette dans le trou latéral de l´adaptateur et tourner vers la droite)

c) Abaisser le levier sur l´adaptateur (pour cela, pousser le levier à fente en direction du manche)



Indications du fabricant pour le procédé de traitement de dispositifs médicaux d´après la norme DIN EN ISO 17664 :2004

Hersteller: HAGER & WERKEN GmbH & Co. KG
Ackerstraße 1
47269 Duisburg, Germany
T +49 (203) 99269-0
F +49 (203) 299283
www.hagerwerken.de

Restriction pour la remise en état : Une remise en état répétée n´a que très peu de conséquences sur cet instrument. La fin de longévité de l´instrument est dictée principalement par l´usure et l´endommagement par l´utilisation.

A l´endroit d´utilisation : Eliminer la saleté superficielle avec un mouchoir à usage unique ou une serviette en papier.

Conservation et transport : Pas d´exigences particulières.

Préparations pour le nettoyage : Aucunes

Nettoyage : Utiliser un produit de nettoyage convenable pour l'acier inox selon les instructions du fabricant respectif. Eliminer tous les restes de nettoyant à l´eau courante.

Désinfection : Utiliser un désinfectant convenable pour l'acier inox selon les instructions du fabricant respectif. Eliminer les restes de solution désinfectante à l´eau courante.

Entretien : Pas d´exigences particulières.

Emballage : Un sachet d´emballage pour stérilisation aux normes peut être utilisé (recommandé)

Stérilisation : À la vapeur (autoclave), à 134° C pendant 5 minutes. À la vapeur (autoclave), à 121° C pendant 15 minutes.

Contrôle/test de fonction : Examen à vue sur dommages, usure et déformation.

Magasinage : Pas d´exigences particulières.

Les instructions ci-dessus ont été validées comme « APPROPRIÉES » par le fabricant de produits médicaux pour la préparation d´un produit médical et sa ré-utilisation. Il incombe à l´opérateur de veiller à ce que le traitement mené réellement avec l´équipement, les matériaux et le personnel dans le local de traitement apporte le résultat souhaité. Normalement cela demande une validation et surveillance habituelle. De meme, il faut examiner soigneusement que tout éloignement des instructions fournies par le fabricant n'amenuise pas l'efficacité et n'apporte pas de consequences negatives.